


Fiche technique : utilisation du logiciel AUDACITY

Les commandes

Sélectionner une partie de l'enregistrement

Lancer l'enregistrement

Arrêter l'enregistrement

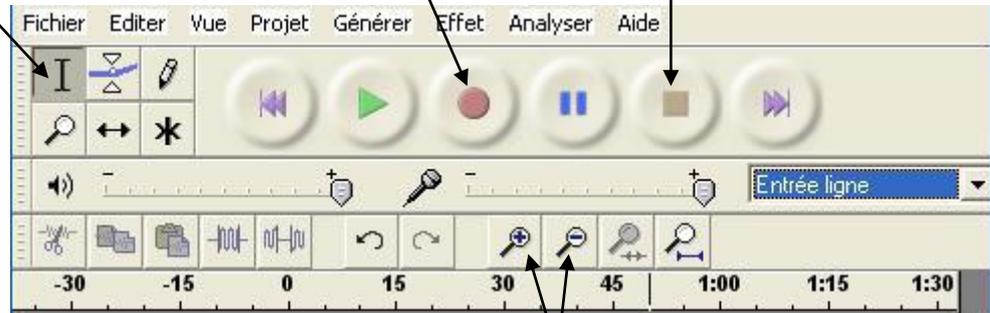


Repérage du temps


Zoomer (avant, arrière) la partie sélectionnée

Vérification de l'orientation des deux piézomètres


Orientation opposée

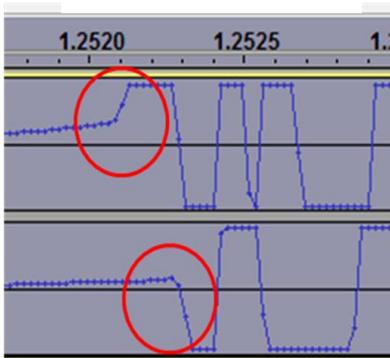

Orientation identique

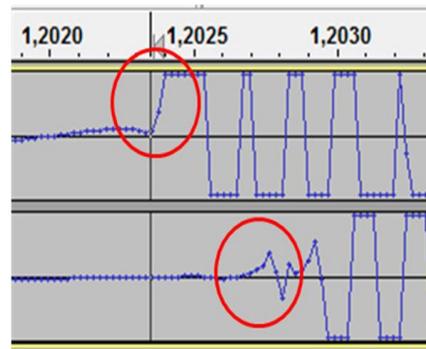

Exploitation de l'enregistrement

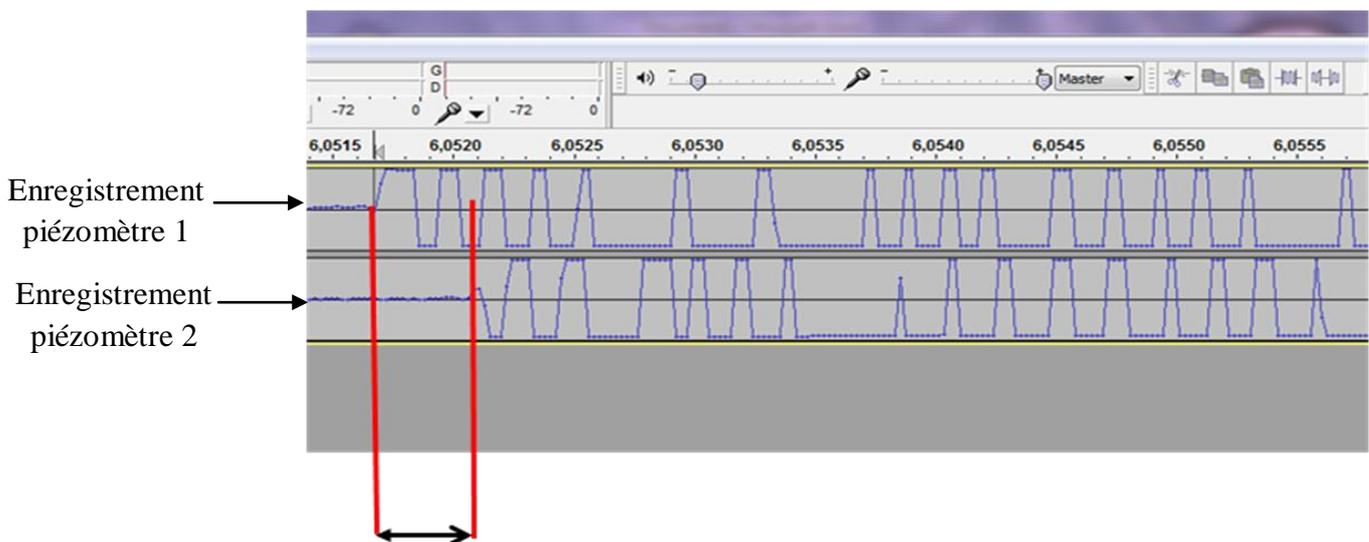

Temps de parcours de l'onde : 4 ms.